



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH23008-2311

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd

No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net

Дата виготовлення: 05.2023


Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

Назва продукції	Шприц інсуліновий 1 мл 100 МО		
Модель / тип	1 мл	Серія	280523
Нормативні документи	JK 53/06	Кількість зразків	30 шт
Умови випробувань	Відповідають вимогам	План відбору зразків	GB/T 2828.1-2003
Стан зразка	У гарному стані	Дата перевірки	2023-05-28~2023-06-05
Назва досліджуваного показника	Технічні вимоги	Результат випробування	Висновок
Зовнішній вигляд	Прозорий, чистий, без задирок і домішок	Відповідає	Придатний
Герметичність поршня	При осьовому натисканні = 60 + 5s: не повинно бути просочування повітря і рідини	Відповідає	
Вістря голки	Повинне бути гострим, не мати рваних країв та задирок	Відповідає	
Розмір	100 одиниць U-100	Відповідає	
Шкала	Шкала чітка, рівна, правильна	Відповідає	
Мастило	Не повинно бути видно крапель або частинок мастила.	Відповідає	
Стерильність	Має бути стерильним	Відповідає	
Остаточна кількість етиленоксиду (EO)	Має бути ≤ 5 мг/г	Відповідає	
Примітки	/		

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

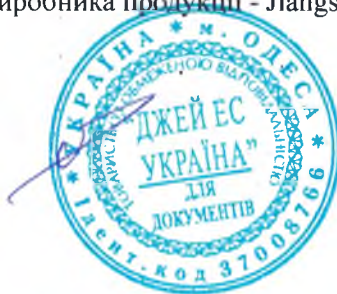

Сохань С.Є.